


最大最小值趨勢圖報表(60分):B1F藥庫(室溫櫃-C)YMPR-50ADC溫度

2019/08/01 00:00~2019/09/01 12:00

1/1



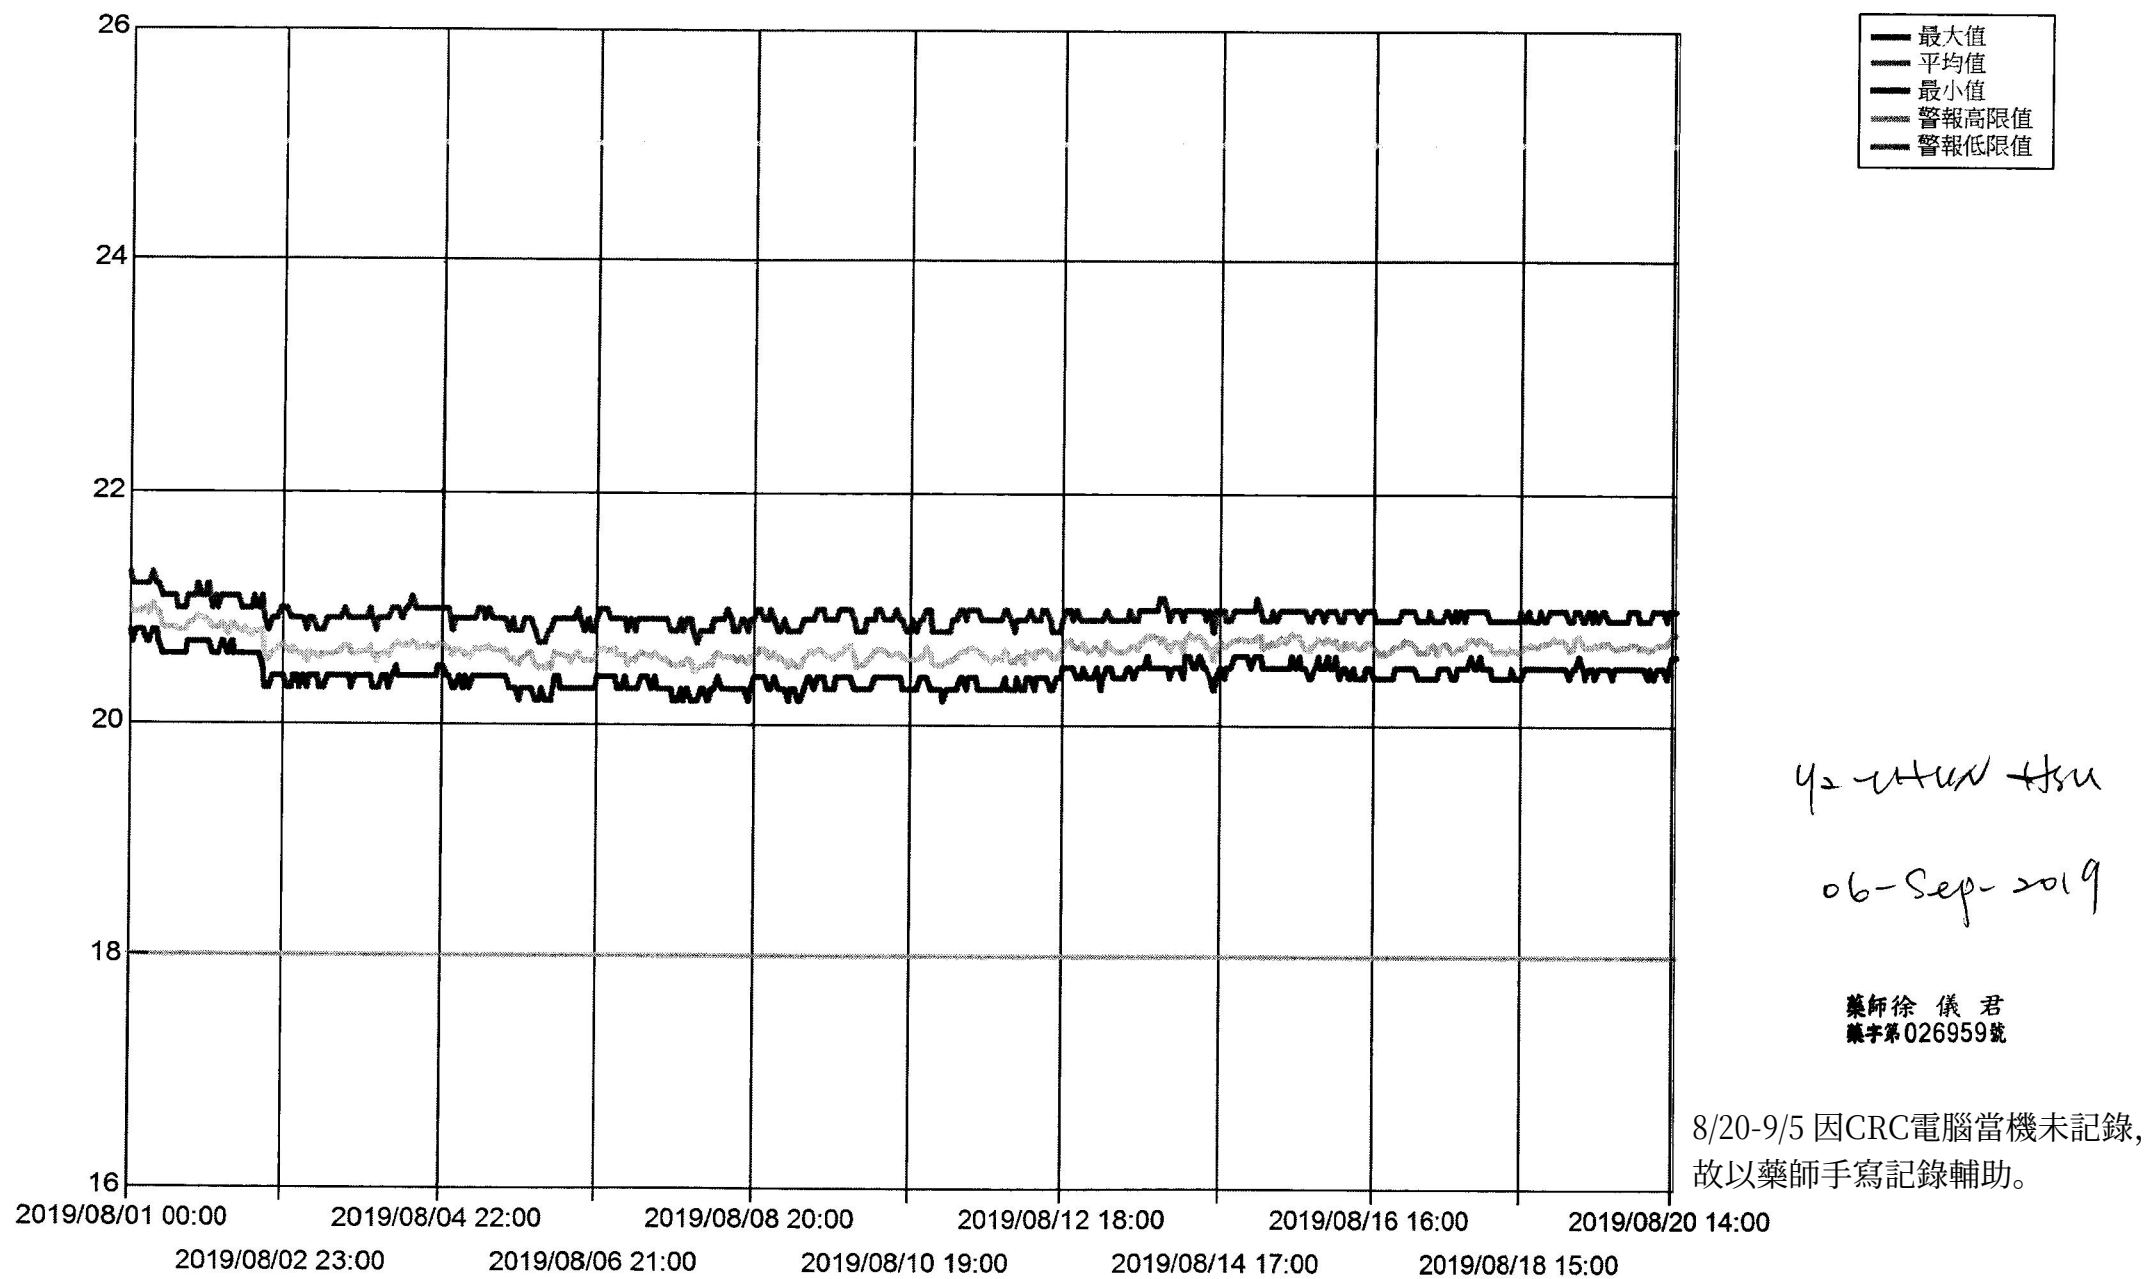

日期	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
班別	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00
溫度	溫度標示方式：× 代表最高溫、○ 代表最低溫、● 代表即時溫。 正常溫度範圍冷藏 18°C ~ 25°C，查核後請簽名(勿簽代號)													
30														
28														
26														
24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20														
18														
16														
14														
12														
簽名														
異常處理														
原因														

組長簽章：

 藥師 孫國倫
 藥字第027795號

組長簽核

 藥師 孫國倫
 藥字第027795號

- 溫度異常時，初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後，務必在一小時內再次確認溫度。
- 異常處理方法：A：調低冷藏控制閥(冷度轉強) B：調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C：經初步處理溫度仍異常，將冰箱藥物移至其他冰箱
D：連絡電機室值班人員，分機 2202 (24 小時)
- 原因：請註明 A：插頭脫落 B：冰箱故障 C：其他

2016.01 藥劑部修訂



日期	26	27	28	29	30	31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6		
星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
班別	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00	03:00 08:00 17:00 22:00
溫度	溫度標示方式：× 代表最高溫、○ 代表最低溫、● 代表即時溫。 正常溫度範圍冷藏 18°C ~ 25°C，查核後請簽名(勿簽代號)													
30														
28														
26														
24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20														
18														
16														
14														
12														
簽名	林	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子
異常處理														
原因														

組長簽章：藥師 孫國倫
藥字第027795號

組長簽核：

- 溫度異常時，初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後，務必在一小時內再次確認溫度。
- 異常處理方法：A：調低冷藏控制閥(冷度轉強) B：調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C：經初步處理溫度仍異常，將冰箱藥物移至其他冰箱
D：連絡電機室值班人員，分機 2202 (24 小時)
- 原因：請註明 A：插頭脫落 B：冰箱故障 C：其他

2016.01 藥劑部修訂