


單一測點報表(60分):試驗藥局 -20°C冰箱溫度

2020/05/01 00:00~2020/06/01 23:59

26/26

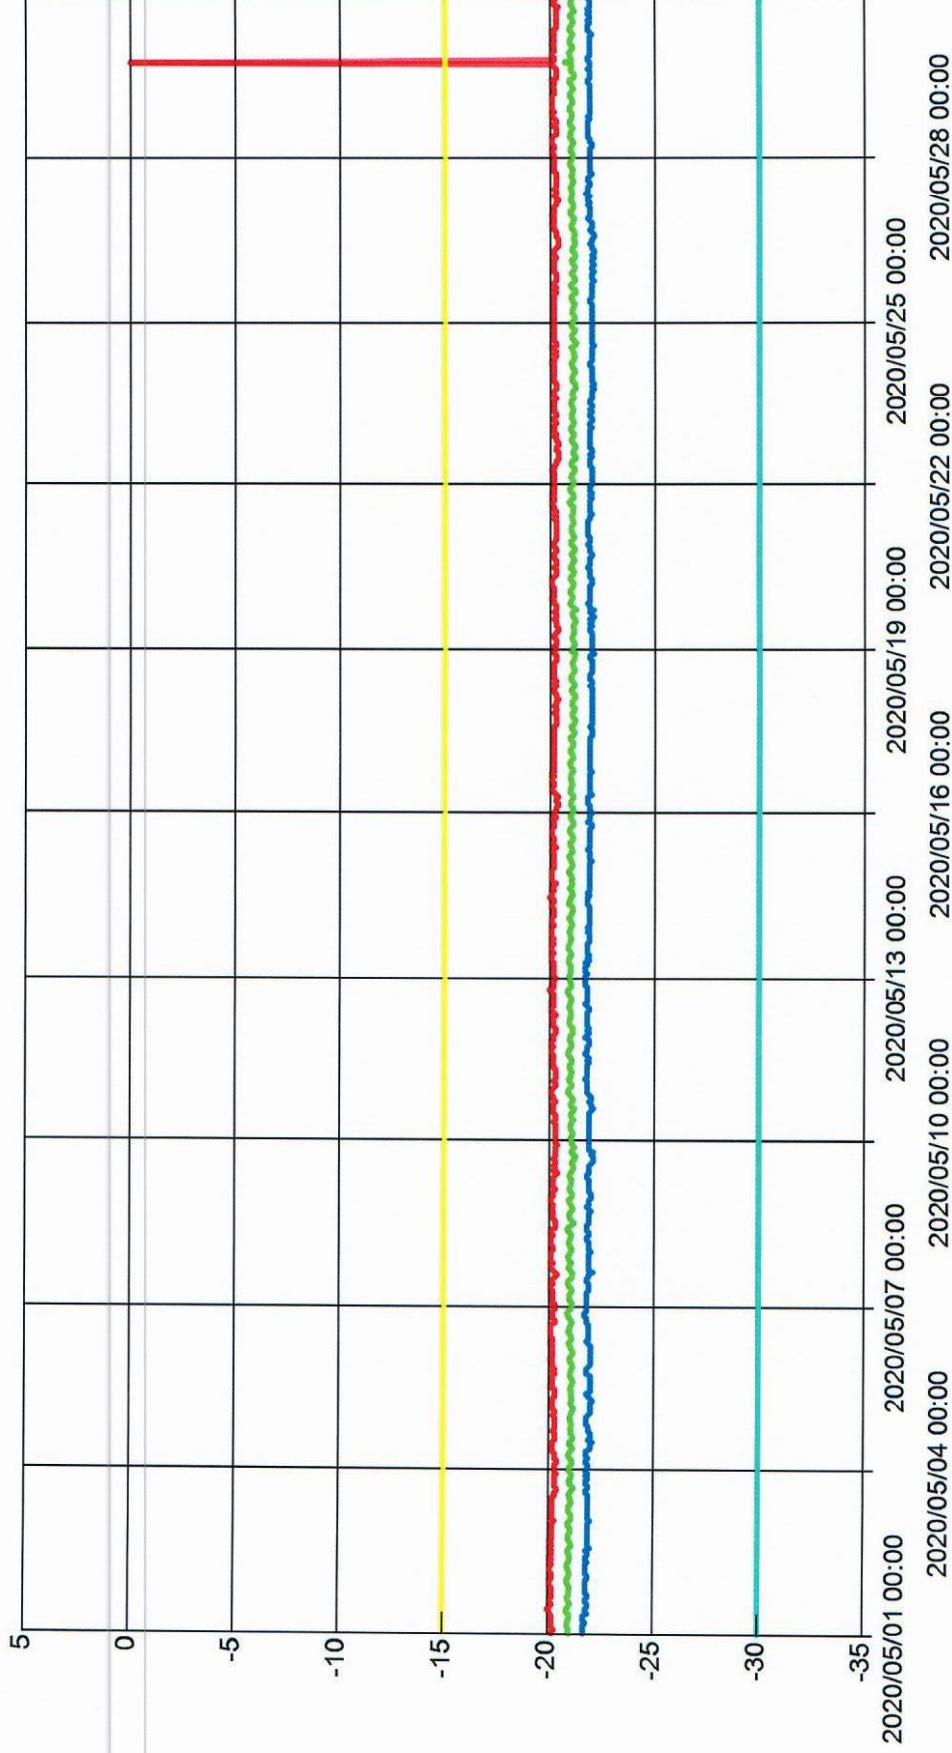

5/29 18:25-18:27

因電腦重新開機導致數據未記錄。-20度冰箱正常運作。

ys-watan tsm

02. Jun. 2020

藥師徐儀君
藥字第026959號